
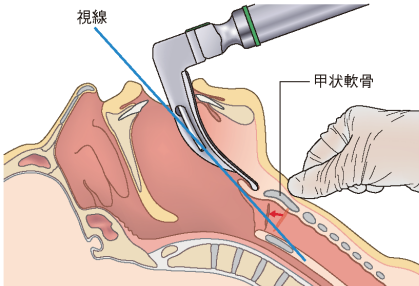
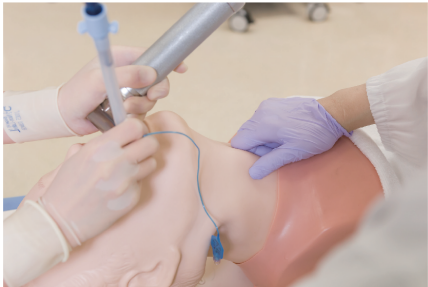
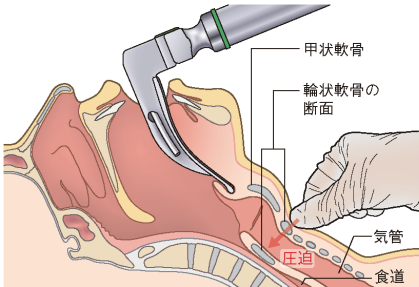

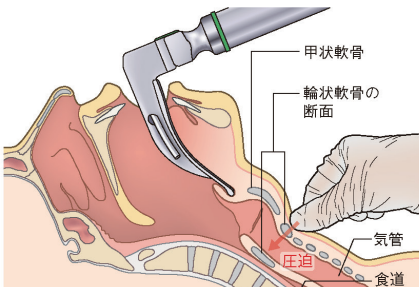
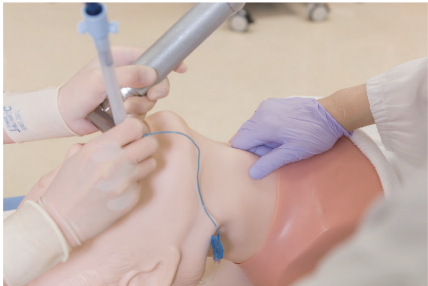
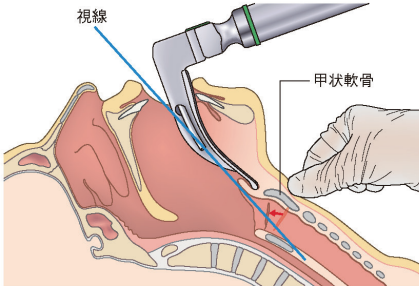


# お詫びと訂正

「見てできる臨床ケア図鑑 周術期ビジュアルナーシング」において、誤りがございました。下記のように訂正し、読者の皆様にお詫び申し上げます。

(2019年5月9日)

訂正箇所	p.111～112 ②喉頭鏡の挿入 ポイント 図
<p>誤</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>BURP法</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>視線 甲状軟骨</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>輪状軟骨圧迫法</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>甲状軟骨 輪状軟骨の断面 気管 食道 圧迫</p> </div> </div>
<p>正</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>BURP法</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>甲状軟骨 輪状軟骨の断面 気管 食道 圧迫</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>輪状軟骨圧迫法</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>視線 甲状軟骨</p> </div> </div>

訂正箇所	誤	正
p.82 図 3-3	 <p>The '誤' (Incorrect) column shows three examples of sterilization labels. The top row shows two autoclave labels: 'オートクレーブ前' (before autoclave) and 'オートクレーブ済' (after autoclave). The middle row shows a gas sterilization label 'ガス滅菌済' (gas sterilized). The bottom row shows a label '滅菌前' (before sterilization). The labels contain text about steam sterilization and include 'AC' and 'EC' logos with model numbers like 0514 and 0411.</p> <p>オートクレーブ前      オートクレーブ済</p> <p>オートクレーブ済</p> <p>ガス滅菌済</p> <p>滅菌前</p> <p>図3-3 滅菌物のラベル</p>	 <p>The '正' (Correct) column shows three examples of corrected sterilization labels. The top row shows two autoclave labels: 'オートクレーブ前' (before autoclave) and 'オートクレーブ済' (after autoclave). The middle row shows a gas sterilization label 'ガス滅菌済' (gas sterilized). The bottom row shows a label '滅菌前' (before sterilization). The labels contain text about steam sterilization and include 'AC' and 'EC' logos with model numbers like 0514 and 0411.</p> <p>オートクレーブ前      オートクレーブ済</p> <p>ガス滅菌済</p> <p>オートクレーブ済</p> <p>滅菌前</p> <p>図3-3 滅菌物のラベル</p>